

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MIEJSKI SZPITAL ZESPOLONY

ul. Mirowska 15 42-202 Częstochowa Centrala tel. 370 22 22, fax. 370 27 92
e-mail: sekretariat@zsm.czyst.pl <http://www.zsm.czyst>



ISO 9001
OHSAS 18001

Częstochowa dnia 07.05.2020 r.

Do wiadomości
Firmy biorące udział w postępowaniu

Wyjaśnienia nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:

„Zakup i dostawa kabli EKG, czujników SPO2, mankietów, czujników temperatury dla SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespólnym w Częstochowie”.

Zapytanie zostało ogłoszone na stronie internetowej www.zsm.czyst.pl, SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespólnego w Częstochowie w dniu 04.05.2020 r.

Pyt. 1

Pytanie 1 Pakiet 6 Pozycja 1

Czy Zamawiającemu chodzi o kabel kompletny czy same odprowadzenia ?



Odpowiedź: Pakiet 6 Pozycja 1 – odprowadzenia.



Pyt. 2

Pytanie 2 Pakiet 6 Pozycja 1

Jeżeli mają być same odprowadzenia, to do jakiego kabla głównego. Na zdjęciach jest tylko moduł, brak zdjęcia wtyczki kabla.

Odpowiedź: Wielorazowe odprowadzenia EKG typu Mindray zatrask, zgodnie z załączonym zdjęciem poniżej

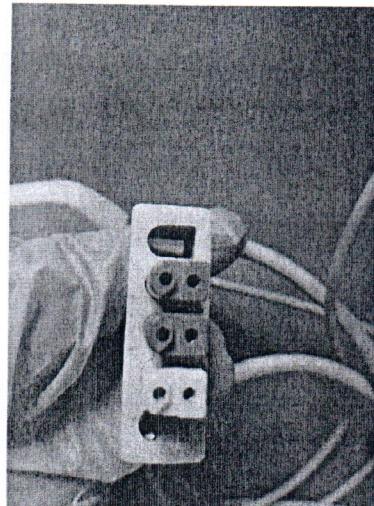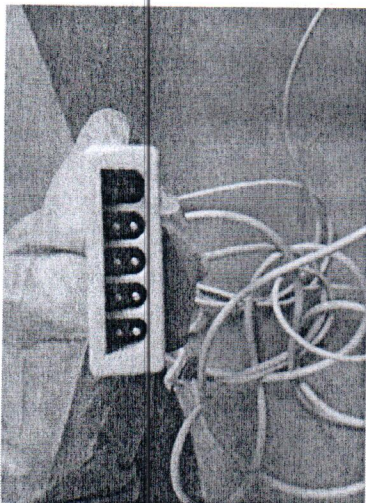

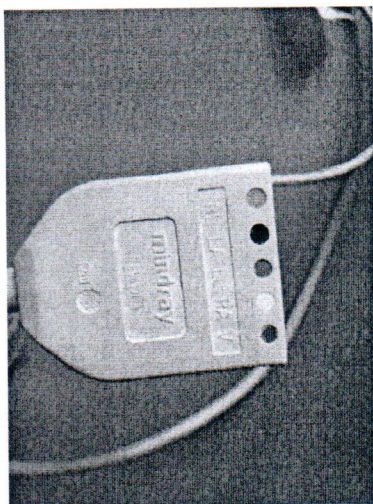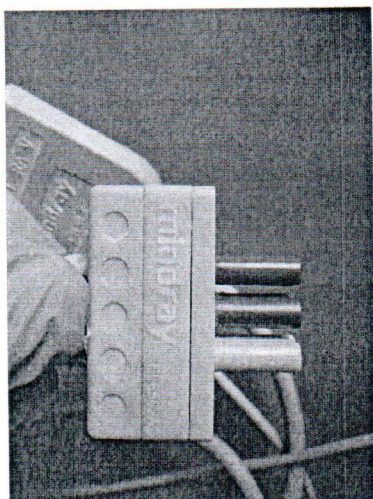

Pyt. 3

Pytanie 3 Pakiet 11 Pozycja 5

Czy Zamawiającemu chodzi o komplet ? Czyli adapter SpO2 plus czujnik SpO2? Na to wskazuje zdjęcie a opis jest niejasny.

Odpowiedź: Czujnik SpO2

Pyt. 4

Pytanie 4

Czy Zamawiającemu pozwoli, ze względu na pandemię Covid-19, na wysłanie oferty drogą elektroniczną, podpisanej elektronicznie ?

Odpowiedź: Tak

Pyt. 5

Pytanie nr 1.

Ze względu na wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego zgodnie z zaleceniami Urzędu Zamówień Publicznych prosimy o dopuszczenie elektronicznej formy złożenia oferty w niniejszym postępowaniu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pyt. 6

Formularz asortymentowo-cenowy

Dotyczy Pakiet nr 11, pkt 5

Pytanie nr 2.

Czy Zamawiający przez „Kabel SPO2 wielorazowego użytku” miał na myśli: „Przewód pośredni przyłączeniowy SpO2 o dł. min 2,5m”, „Wodoszczelny czujnik SpO2 typu klips na palec, długość przewodu min 1,6m”, czy oba te elementy?

Odpowiedź: Czujnik SpO2

Pyt. 7

Dotyczy Pakiet nr 11

Projekt umowy - §4 ust. 2

Pytanie nr 3.

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną prosimy o uwzględnienie opóźnień wynikających z działania siły wyższej, nie stanowiących winy wykonawcy. Prosimy o dopisanie do paragrafu zgodnie ze wzorem poniżej:

§4 ust. 2. (...) złożonego w formie pisemnej, faksem, e-mailem lub telefonicznie, przez osobę wskazaną w ust. 3.

§4 ust. 3. Jeżeli ostatni dzień terminu dostawy wypada w dniu wolnym od pracy, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie. Jeżeli w okresie od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia upływu określonego w niej terminu dostawy urządzeń wystąpi niezależna od Wykonawcy przeszkoda uniemożliwiająca Wykonawcy wykonanie dostawy urządzeń zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, termin dostawy ulega zawieszeniu na okres trwania tej przeszkody, i zaczyna biec na nowo po jej ustaniu. Za niezależne od Wykonawcy przeszkody uniemożliwiające Wykonawcy wykonanie dostawy urządzeń zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy strony uznają szczególności wszelkie decyzje władz publicznych związane z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz opóźnienia dostaw asortymentu od producenta.

§4 ust. 4. O wystąpieniu przeszkody uniemożliwiającej Wykonawcy wykonanie dostawy w terminie o którym mowa §4 ust. 2 Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego niezwłocznie.

§4 ust. 5. *Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą (...)*
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. Jednocześnie, mając na uwadze ogłoszenie stanu epidemicznego deklaruje, że w okresie obowiązywania stanu epidemicznego kara umowna nie będzie nakładana, jeżeli wykazane zostanie w sposób jednoznaczny i niebudzący wątpliwości, iż zdarzenia, które mogłyby stanowić podstawę do naliczenia kary umownej powstały z przyczyn niezależnych od Wykonawcy

Pyt. 8

Dotyczy Pakiet nr 11

Projekt umowy - §6 ust. 1a

Pytanie nr 4.

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną prosimy o uwzględnienie opóźnień wynikających z działania siły wyższej, nie stanowiących winy wykonawcy. Prosimy o modyfikację niniejszego paragrafu zgodnie ze wzorem poniżej:

§6 ust. 1a. *za opóźnienie w realizacji umowy w terminie określonym w § 4 ust 2, karę umowną w wysokości 1% wartości brutto danego zamówienia za każdy dzień opóźnienia, z wyłączeniem §4 ust. 2;*

Odpowiedź: Patrz pytanie 7

Pyt. 9

Dotyczy Pakiet nr 11

Projekt umowy - §8 ust. 1

Pytanie nr 5.

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną prosimy o uwzględnienie występowania siły wyższej jako podstawy do zmian w zakresie umowy zgodnie z poniższym wzorem:

§8 ust. 1c) wystąpienia zdarzeń siły wyższej, jako zdarzenia zewnętrznego niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia jego skutkom; przez siłę wyższą Strony Umowy rozumieją następujące zdarzenia: wojna, działania wojenne, rewolucja, przewrót wojskowy, wojna domowa, klęski żywiołowe, takie jak: huragany, powodzie, trzęsienie ziemi, bunt, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niż pracownicy Wykonawcy i jego podwykonawców oraz epidemie, w tym również stan zagrożenia epidemicznego. Wykonawca nie jest odpowiedzialny za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich

zobowiązań

z powodu zaistnienia siły wyższej, tj. jeżeli niewykonanie zostało spowodowane zdarzeniem wywołanym przyczyną zewnętrzną, będącym poza kontrolą Wykonawcy.

Odpowiedź: Patrz pytanie 7

Pyt. 10

Projekt Umowy § 5 pkt 4:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na przesyłanie faktury wraz z dostawą towaru w formie papierowej, jeśli nie wyraża zgody na przesyłanie przez Wykonawcę innych niż ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Treść powyższych odpowiedzi stanowi zmianę Opisu Przedmiotu Zamówienia, zamieszczona jest na stronie internetowej Zamawiającego i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

ZATWIERDZIŁ:


DYREKTOR
Wojciech Konieczny